


**Система координат для построения калибровочной кривой
с помощью набора «Тех-Фактор IX-тест» (кат. № 679)**

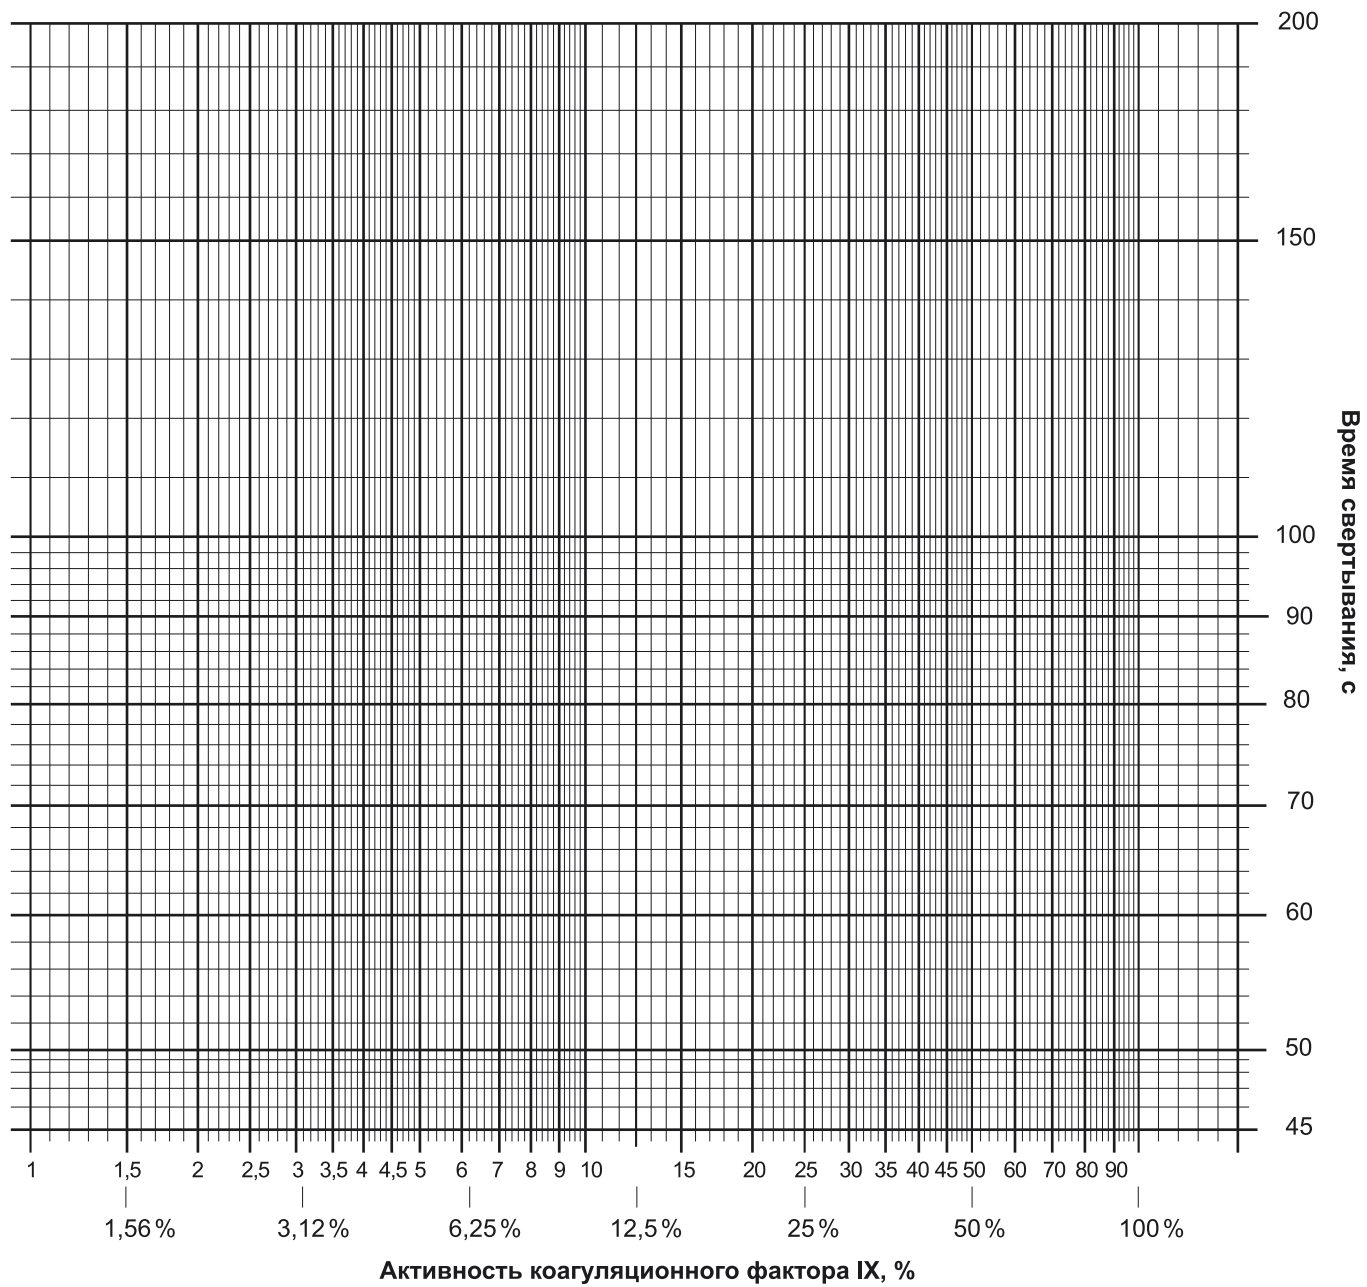

| Активность коагуляционного фактора IX, % | Время свертывания, с |
|--|----------------------|
| 100 | |
| 50 | |
| 25 | |
| 12,5 | |
| 6,25 | |
| 1 | |